

LA RÉVOLUTION DU FROID !



NOUVEAUX APPLICATEURS
PLUS DE ZONES DU CORPS
MEILLEURS RÉSULTATS

crystile
advanced

RÉDUCTION DU TISSU ADIPEUX
PAR CRYOADIPOLYSE

by cocoon medical

crystile advanced

Réduction du tissu adipeux de manière non invasive.



DÉCOUVREZ COMMENT LA TECHNOLOGIE DU FROID VA CHANGER VOTRE CENTRE

Grâce à sa technologie de cryoadipolyse révolutionnaire, la nouvelle crystile advanced est le **dispositif n°1 dans le remodelage corporel**.


Notre recherche permanente pour disposer des meilleures méthodes pour traiter la graisse localisée nous a amené à développer le nouveau dispositif **crystile advanced**. Sa technologie révolutionnaire ajoutée à la conception de nouveaux applicateurs différents qui s'adaptent à un grand nombre de zones du corps, rendent le traitement possible sur tous les types de patients et devient ainsi l'alternative la plus versatile dans les traitements remodelants.

APPLICATEURS CRYSTILE ADVANCED

Straight HP		Idéal pour les surfaces plates
-------------	---	--------------------------------

Oval HP spécial hanches		Conçu pour les tissus avec peu d'élasticité
----------------------------	---	---

Curved HP		Spécial pour les zones arrondies
-----------	---	----------------------------------

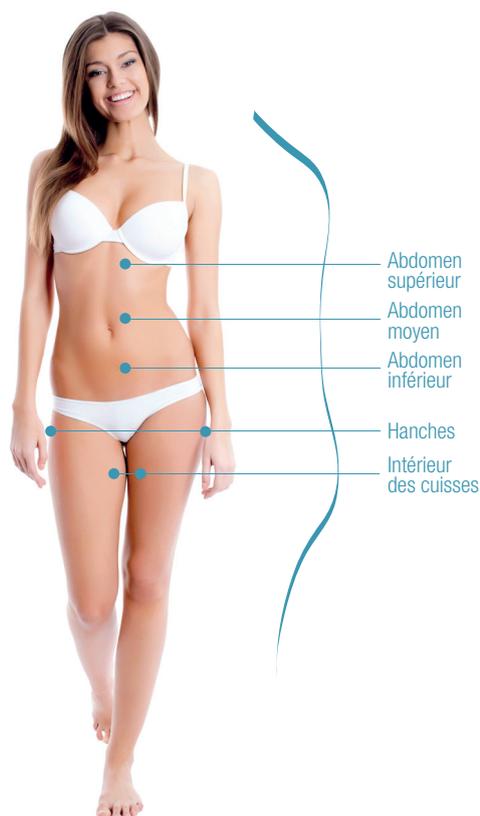

TRAITEMENT N°1
POUR LE PATIENT ET VOTRE CENTRE



DES RÉSULTATS SURPRENANTS ET DES PATIENTS TRÈS SATISFAITS

Les résultats incroyables du traitement **crystile advanced** sont remarquables et visibles dès la 1ère séance, les patients sont **satisfaits et fidélisés**.

Demandez une démonstration gratuite dans votre centre dès maintenant et découvrez-le par vous-même !

Cool Gel Pad

MEMBRANE BREVETÉE

cocoon medical a breveté la membrane cool gel pad, qui garantit la sécurité maximale pour le patient.

Son utilisation obligatoire permet de réaliser le traitement avec les meilleurs résultats et la protection maximale pour la peau.

#clinicallyproven

1



2



3



Abdomen



Avant



Après : 1 séance. 7 semaines plus tard

Culotte de cheval



Avant



Après : 1 séance. 8 semaines plus tard

Intérieur des cuisses



Avant



Après : 1 séance. 10 semaines plus tard

FONCTIONNEMENT BASIQUE

Type de dispositif	Dispositif de froid contrôlé pour usage esthétique
--------------------	--

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maximale	130W
Puissance de refroidissement (chaque applicateur)	80 W, 0 °C @ Temp. ambiante 25 °C
Température	-5 °C (Tolérance $\pm 5\% \pm 1\text{ °C}$)
Pression maximale sous vide continu	250mbar
Écart de régulation sous vide	-100 mbar jusqu'à - 250 mbar ($\pm 10\%$)
Durée de programmation	35 à 70 min (erreur $\pm 5\%$)

DURÉE DE PROGRAMMATION

Alimentation	100-240 V
	50 – 60 Hz
	1000 W

DIRECTIVES

CE
 Directive 2006/95/CEE (LVD) relative à la basse tension
 Directive 2004/108/CE (EMC) relative à la compatibilité électromagnétique
 Directive 2002/95/CEE (RoHS)
 Directive 2002/96/CEE (DEEE)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériaux	Métal et finitions en polyuréthane
Dimensions (base non incluse)	492 x 446 x 647 mm
Poids	38 Kg
Écran	Écran tactile 10, 4"

feeling the innovation
www.cocoonmedical.com